Installation des Untersuchungstisches für die Pädiatrie

Für Modelle:
640 (alle)

Besondere Werkzeuge:
Wasserwaage

Schritt 1: Entfernen des Tisches von der Platte

A. Drei Versandschrauben entfernen.
B. Tisch vorsichtig von der Platte heben.
(Richtige Hebepunkte siehe Abbildung).

Gerätewarnung
Tisch nicht an der gepolsterten Auflage anheben. Hinweise auf die richtigen Hebepunkte siehe Abbildung.

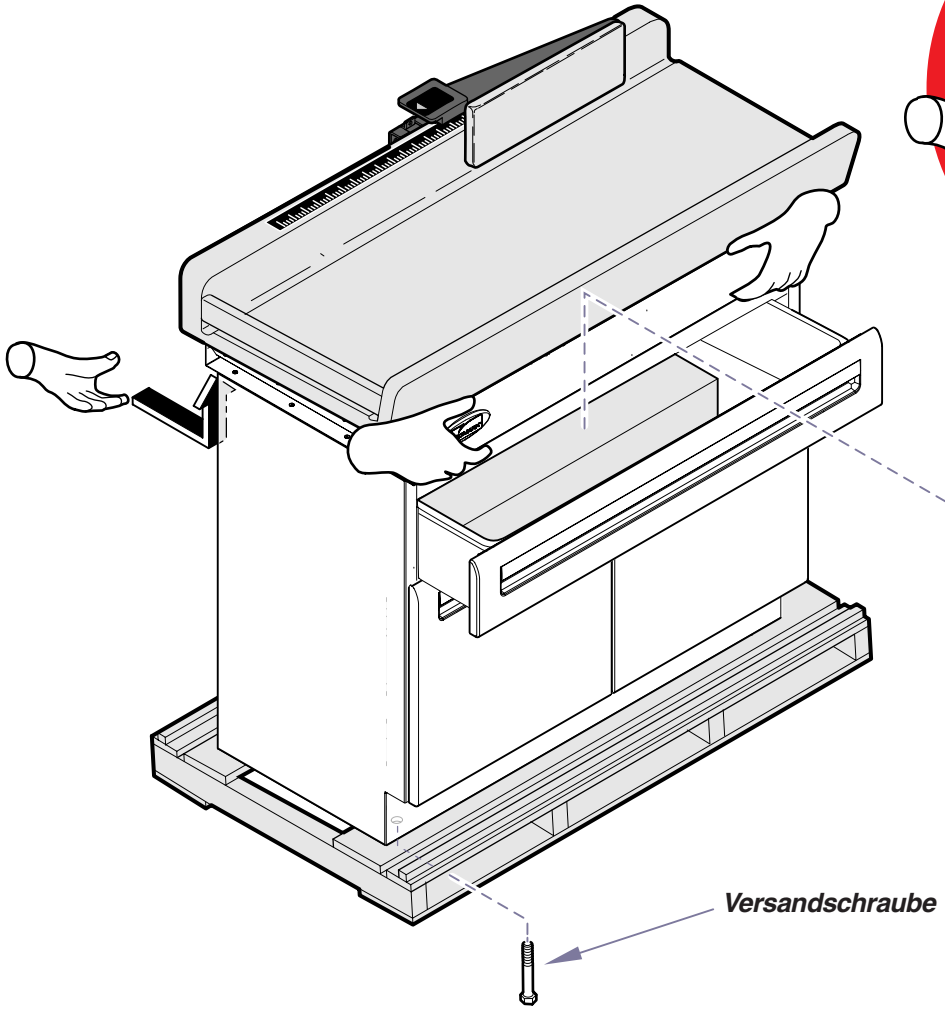





Nivellierfüße (Anz.: 4)

Regalträger (Anz.: 4)

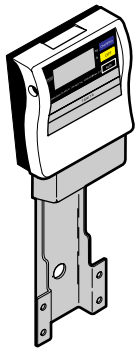

Digitale Waage (Anz.: 1)

Schrauben (Anz.: 4)

Kabelklemmen (Anz.: 2)



Wechselstromadapter (Anz.: 1)

MA777900i

©Midmark Corporation 2007

Schritt 2: Installieren der digitalen Waage.

A. Waagenhalterung mit vier Schrauben an der Tischrückseite befestigen.

B. Kabeln an der digitalen Anzeige anschließen.
(Für den richtigen Anschluss muss der Pfeil zur Vorderseite der digitalen Anzeige zeigen).

C. Kabel in der Kabelklemme einrasten lassen.

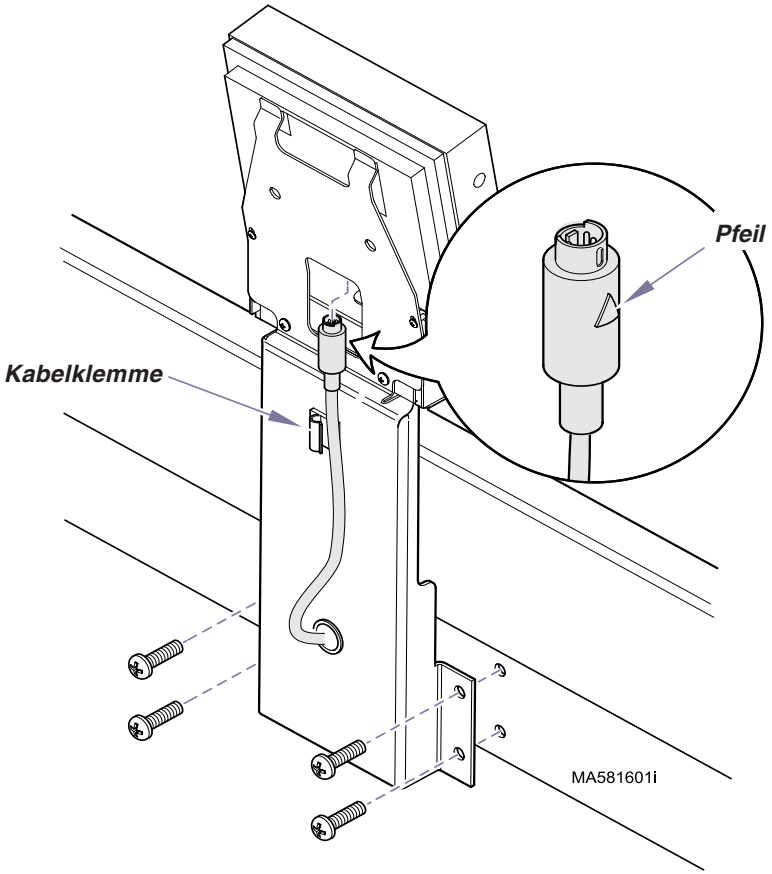

Schritt 3: Stromzufuhr zur digitalen Waage

Batterien einlegen oder Wechselstromadapter an der Waage anschließen.

Anschluss des Wechselstromadapters

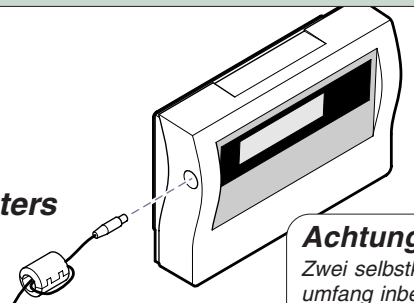

Achtung

Zwei selbstklebende Kabelklemmen sind im Lieferumfang inbegriffen. Sie können zur Befestigung des Adapterkabels am Tisch, an der Wand usw. verwendet werden (siehe Abbildung unten).

Kabelklemmen

****Elektrische Bestimmungen***

120 V AC, 60 Hz, 5 W

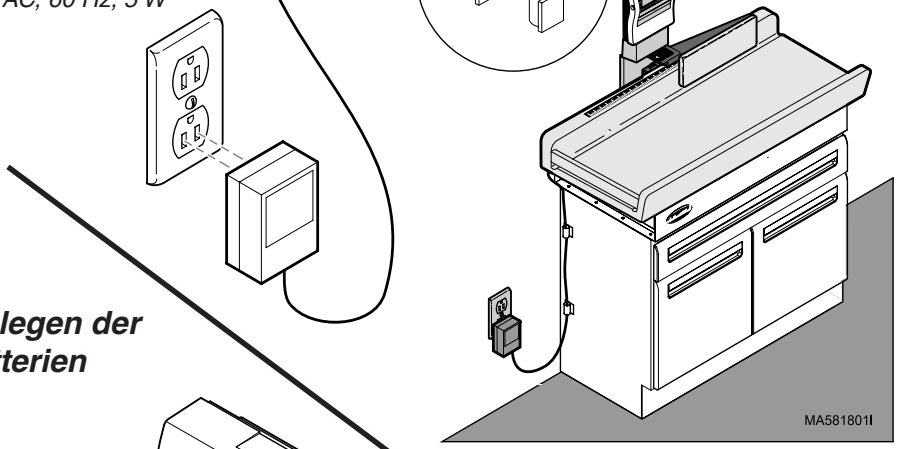

Einlegen der Batterien

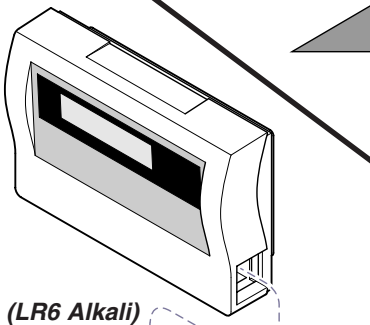

Batteriegröße: AA (LR6 Alkali)
Anzahl: sechs (6)

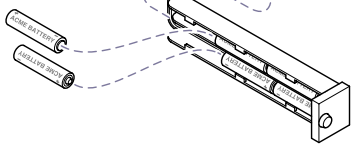

© Midmark Corporation 2007

Gerätewarnung

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss der Tisch waagerecht sein.

Schritt 4: Nivellieren des Tisches

A. Vier Nivellierfüße installieren.
B. Wasserwaage auf den Tisch legen.
C. Nivellierfüße justieren, bis der Tisch vollkommen waagerecht ist.

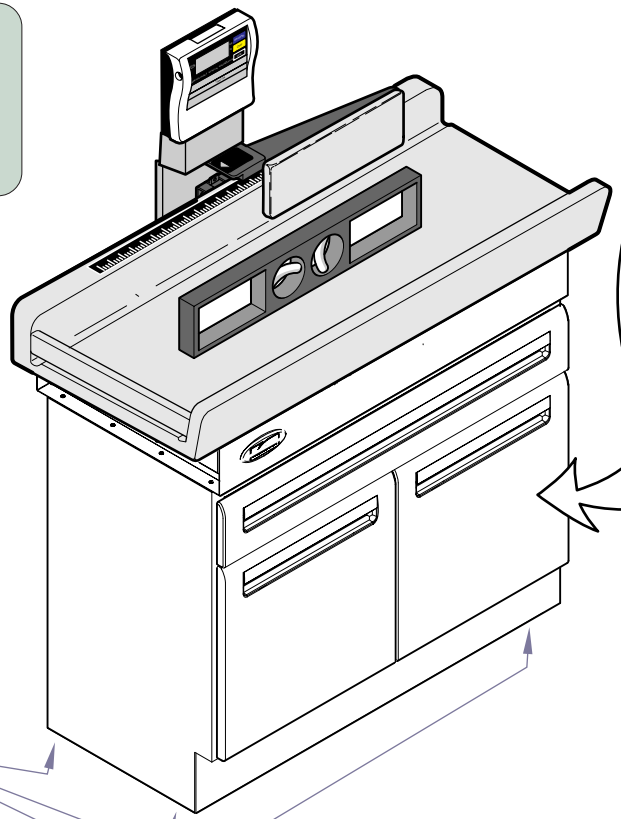

Nivellierfüße
Anz.: 4 (1 Fuß in jeder Ecke)

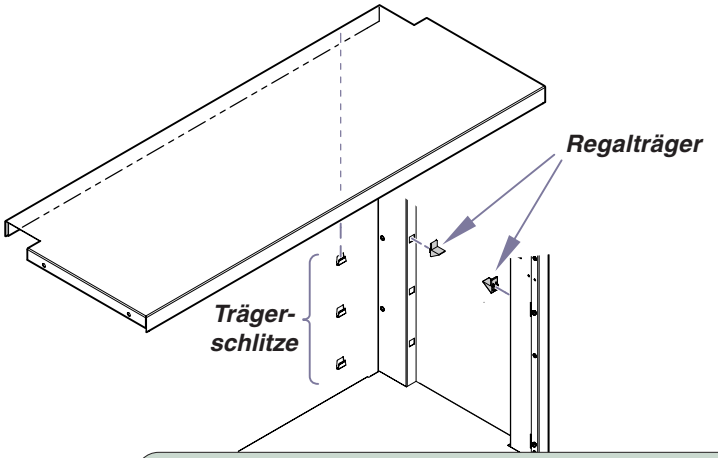

Schritt 5: Installieren des Ablagefachs

A. Vier Regalträger auf gewünschter Höhe anbringen.
B. Rückseitige Lasche des Ablagefachs in die Schlitze einrasten lassen.
C. Ablage auf Regalträger absinken lassen.

Vertikale Einstellung
Schraube an beiden Scharnieren lockern. Tür nach oben/unten bewegen und Schrauben dann nach Bedarf festziehen.

Tiefeneinstellung
Tür mithilfe dieser Schraube nach vorne/hinten bewegen.

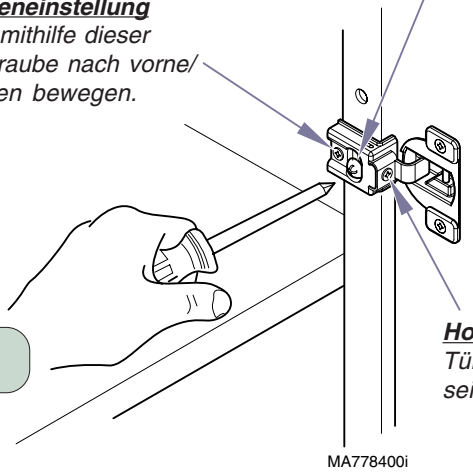

Horizontale Einstellung
Tür mithilfe dieser Schraube seitwärts bewegen.

Schritt 6: Türen nach Bedarf justieren.

MA778400i

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380-0286, USA
Tel.-Nr.: 937-526-3662
Fax: 937-526-5542
www.midmark.com

MIDMARK®
Because we care.

©Midmark Corporation 2007